

DEFIGARD HD-7

Monitor/Desfibrilador



SCHILLER
The Art of Diagnostics

Su apoyo profesional



MODO DE DESFIBRILACIÓN

- Marcapasos fijo y a demanda.
- DESA.
- Desfibrilación manual (sincrónica y asincrónica). 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-30-50-70-90-100-120-150-170-200.
- Tecnología de Onda Bifásica con pulsos, **Multipulse Biowave®**, con duraciones de fases constantes para compatibilidad fisiológica óptima.

ENERGÍA

- **DEA adultos:** 150/200/200 J; pueden configurarse otros parámetros de energía.
- **DEA niños:** 50/50/50 J; pueden configurarse otros parámetros de energía.
- **Desfibrilación interna (cucharillas):** 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-30-50 J.

RCP

- Metrónomo y guía de RCP integrados.
- Sensor feedback CPR **ARGUS LifePoint** (opcional). Permite la medición de la frecuencia, profundidad y precisión. IP 66.
- **Free CPR** opcional (medición de velocidad RCP a través de pads electrodos adhesivos multifunción).



SCAN ME

Renovando el monitoreo y la desfibrilación



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Equipo protegido contra cuerpos extraños de un diámetro mayor que 2.5mm y contra las salpicaduras de agua.
- **Batería de alimentación:** Ion de Litio 11 V, 6.4 Ah, 70.4 Wh.
- **Autonomía:** 250 descargas con batería totalmente cargada o monitoreo de 8 horas con 32 mediciones PANI.
- **Tiempo de carga 90%:** 2 horas después de la descarga completa con el dispositivo apagado.
- **Memoria:** 24h de ECG.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Conexiones:** Cable de paciente de ECG, SpO₂, NIBP, etCO₂.
- **Interfaces:** USB y Wi-Fi (SEMA, SCHILLER Server). Transmisión de captura de pantalla y DII largo. Descarga y análisis de tendencias.
- **Electrodos de desfibrilación:** Electrodos para adultos con 80cm² de superficie activa, electrodos pediátricos con 42cm² de superficie activa.
- Palas para adultos con 69,5cm² de superficie activa convertibles a palas pediátricas con 17cm² de superficie activa.
- **CPR Feedback:** Metrónomo incluido. Opcional: FreeCPR. Opcional feedback completo RCP a través de Sensor Argus LifePoint.
- Modo DESA con software que incluye identificación de FV fina (amplitud pico a pico 100 y ≤200 µVV).
- Opcional palas de desfibrilación internas (cucharillas).

USO RECOMENDADO

- Uso hospitalario.
- Traslado intrahospitalario.
- Traslado asistencial terrestre de mediana y alta complejidad.

Especificaciones técnicas

INTERFACES Y COMUNICACIÓN

Interfaz: Ethernet (mediante adaptador USB) y USB 2.0. Integrado.
Wi-Fi: 802.11b, g, n – Seguridad: WEP, WPA, WPA2 Personal y WPA2 Enterprise. Integrado.
Capacidad de transmisión al servidor de SCHILLER.
Mas de 10 idiomas disponibles accediendo al menú de lenguaje.

MARCAPASOS

Modos: A demanda o Frecuencia fija.
Frecuencia de salida: Configurable en pasos de 40, 45, 50, 60, 70... 240 latidos/min.
Corriente de salida: Configurable a 0 (marcapasos apagado) y luego a partir de 10...200 mA.

MONITOREO DE CONSTANTES VITALES

ECG: 6 derivaciones (DI, DII, DIII, AVL, AVF, AVR).
SpO₂: Masimo.
NIBP/PANI: Método oscilométrico. SYS-DIAS-PAM. Histórico 4 últimas mediciones.
EtCO₂: Sidestream Masimo integrado, para paciente con o sin TOT.

PARÁMETROS MEDIDOS

- **ECG**
Electrodos: Cable de 4 puntas, adquisición simultánea de 6 derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF.
Rango Frecuencia cardíaca: 15 a 350 lpm.
Sensibilidad: 0,25, 0,5, 1, 2 cm/mV.
Gestión de calidad de las derivaciones: detección de derivación desconectada.
- **SpO₂**
Tecnología: Masimo SET o Nellcor (en desarrollo).
Parámetros: SpO₂, pulso periférico.
Sensores: Sensores reusables, desechables y multiuso para adultos y niños, para la medición en el dedo, la oreja o el pie.
- **NIBP**
Método de medición: Oscilométrico.
Mediciones: Manual, automática y función de bloqueo venoso.
- **etCO₂ Sidestream (flujo lateral)**
Método de medición: Módulo de flujo lateral Masimo integrado.
Parámetros: etCO₂, frecuencia respiratoria y apnea.

Tecnología de onda bifásica Multipulse Biowave®



Desfibrilación a baja energía con el mínimo daño

Un pulso de desfibrilación debe garantizar, en lo posible, eficiencia y seguridad, por lo cual **SCHILLER** desarrolla la tecnología **Multipulse Biowave®**.

La energía liberada más allá del periodo de excitación celular, es decir por periodos más largos de lo necesario, es inútil y puede generar daños en las células miocárdicas, por lo tanto debe mantenerse tan baja como sea posible. **Multipulse Biowave®** asegura una desfibrilación altamente efectiva y segura, con muy baja energía y con el mínimo daño.

Es una onda bifásica, es decir, consiste en 2 fases de duración fija de corriente que fluye en direcciones opuestas (bipolar). La diferencia de esta forma de onda (y su principal ventaja) es que es liberada en forma de pulso de alta frecuencia. Ese pulso está cargado de una cantidad de corriente suficiente (= alta eficiencia) y con un requerimiento de corriente particularmente bajo (= muy bajo o cerca a cero nivel de daño). Esto corresponde exactamente al principio de **la mejor desfibrilación posible**.

El pulso de desfibrilación **Multipulse Biowave®** puede adaptarse a diferentes impedancias del paciente, seleccionando un factor de carga del pulso que mantenga constante la corriente media.



DEFIGARD HD-7



DEFIGARD Touch 7

* Las funciones finales de los equipos pueden variar según la configuración solicitada de su equipo y la disponibilidad en cada país. Por favor contacte a su representante SCHILLER, con gusto le atenderá cualquier duda.



SCAN ME

Función Análisis con Anterioridad para Monitores/Desfibriladores HD-7 y DGTouch 7




La desfibrilación temprana marca la diferencia


En una parada cardíaca, contar con la función de **Análisis con Anterioridad** permite una captura de la señal de ECG del paciente desde la conexión de los parches electrodos. Esto permite disponer de la descarga o shock en 1 segundo.

En modo DESA o Desfibrilador Externo Semiautomático (si los artefactos en movimiento no interrumpen la señal) el equipo que cuenta con este software inicia el análisis en background hasta 9 segundos antes de que el dispositivo le avise de manera auditiva al operador que lo iniciará. De este modo, el personal sanitario a cargo de la emergencia puede disponer en segundos de una descarga, si está recomendada. Esos segundos son cruciales para la supervivencia de los pacientes.

Análisis estándar

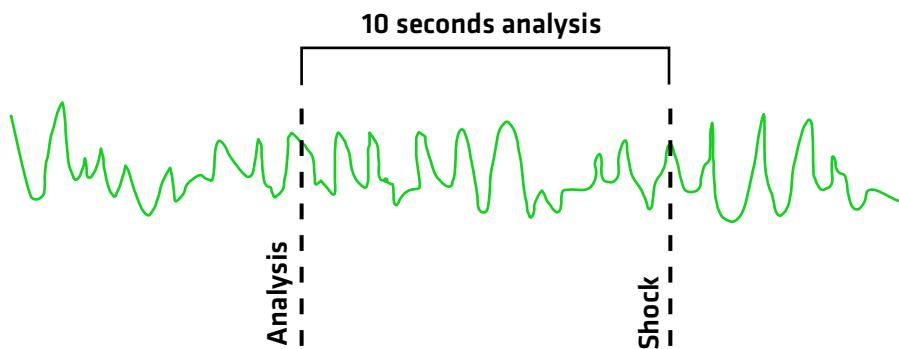

Análisis con anterioridad

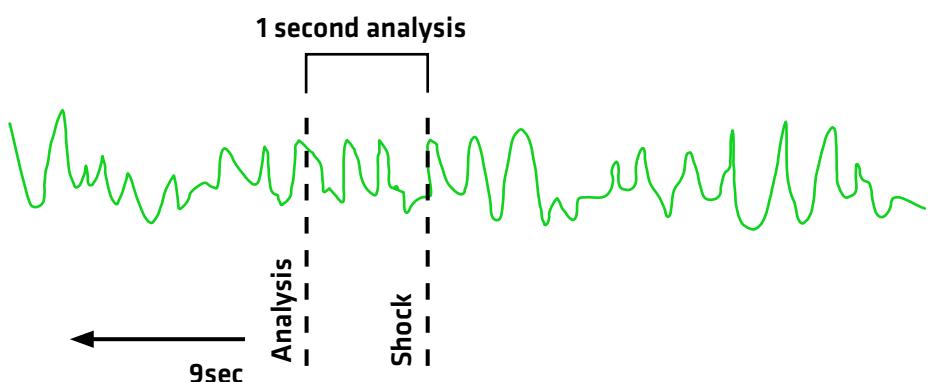

Disponible como licencia para activación en los DEAs Fred PA-1, Fred PA-1 Online, Fred easyport plus, FRED easy G2 y monitores/desfibriladores DEFIGARD HD-7 y DEFIGARD Touch 7.

FreeCPR es una guía auditiva o audiovisual (o ambos) para practicar **RCP** de alta calidad en pacientes con sospecha de parada cardíaca (es decir, la persona no responde, no respira, no tiene pulso). Le proporciona al primer respondiente (ya sea lego o profesional de la salud) información en tiempo real acerca de la calidad de la frecuencia de las compresiones torácicas que le está realizando a la víctima.

CÓMO FUNCIONA

La función opcional **FreeCPR** indica: "comprima más rápido" o "comprima más lento", basándose en la medición de la diferencia de impedancia que se genera durante el ejercicio de la **RCP**, capturada a través de los parches electrodos adhesivos de desfibrilación, como lo indican las recomendaciones de las guías internacionales de **RCP**. Esta función no requiere un sensor adicional.

La velocidad de las compresiones otorgadas por el rescatista o primer respondiente se compara con la velocidad preestablecida del metrónomo en la unidad (configurable a 100, 110, 120 cpm), para así emitir la respectiva indicación. En caso de que la unidad no detecte el inicio de las compresiones (o que capte la ausencia de éstas) proveerá la indicación: "Inicie las compresiones torácicas siguiendo la señal auditiva..." .

Si los **DEAs FRED PA-1, FRED PA-1 Online, FRED easyport plus** o **FRED Easy G2** cuentan con la licencia **FreeCPR**, ésta se activa de manera automática en la fase de **RCP** posterior a la emisión (o la no emisión, si no está recomendada) de una descarga.

La indicación de iniciar las compresiones es auditiva para las soluciones que no cuentan con pantalla (**DEAs FRED PA-1 y FRED PA-1 Online**). Para las soluciones que sí tienen pantalla, la indicación es auditiva y visual.

Si los monitores/desfibriladores **DEFIGARD HD-7** y **DEFIGARD Touch 7** cuentan con esta función, estará disponible en el menú de seguimiento de la **RCP** que se habilita en las opciones de desfibrilación manual, cardioversión y modo DEA/DESA de estos equipos.



* Las funciones finales de los equipos pueden variar según la configuración solicitada de su equipo y la disponibilidad en cada país. Por favor contacte a su representante SCHILLER, con gusto le atenderá cualquier duda.

FreeCPR es una herramienta útil para brindar RCP de alta calidad

GENERACIÓN DE REPORTES


Después de la intervención, las unidades (es decir, nuestros DEAS y monitores/desfibriladores) permiten generar reportes donde se evidencia lo siguiente:

- Trazado electrocardiográfico durante el evento.
- Número de descargas.
- Joules emitidos.

Para la fase de la RCP, el reporte que las unidades pueden generar incluye estos datos:

- La respectiva curva de compresiones torácicas otorgadas por el rescatista, diferenciada por color.
- La obtención de mediciones sobre el tiempo de realización de la RCP en porcentaje.
- Ausencia de la RCP en porcentaje.
- Valor promedio de las compresiones por minuto otorgadas (cpm) que se obtiene gracias a la avanzada función **FreeCPR** exclusiva de **SCHILLER**.

Nota: El formato del reporte posintervención puede variar de acuerdo al modelo del equipo.

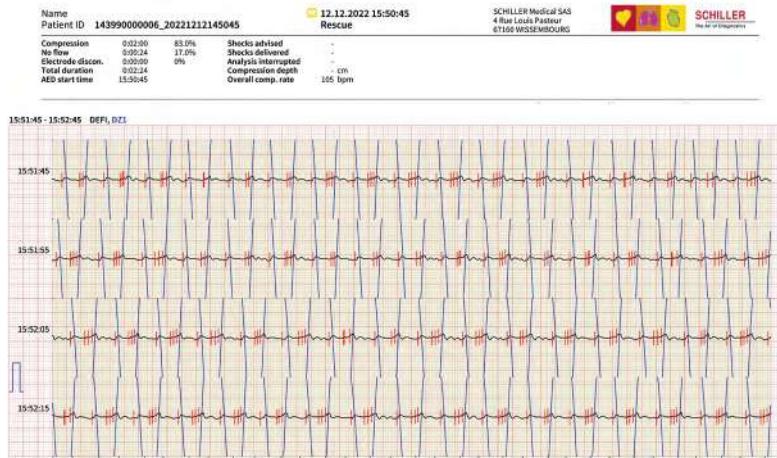

CONCEPTOS GENERALES

La impedancia torácica (IT en español o TTI que son las siglas en inglés de Transthoracic Impedance) es uno de los determinantes del flujo de corriente transmiocárdica, de cuya magnitud depende la despolarización de la masa crítica para la reversión a ritmo sinusal. Se mide en ohms = Ω .

Variabilidad de la impedancia

Se ha demostrado que la variabilidad de la impedancia humana oscila de 25Ω hasta 180Ω . La TTI es la resistencia que ofrece el tórax de una persona al paso de la corriente eléctrica y dicha resistencia varía dependiendo de la masa corporal de cada persona. En condiciones normales, la impedancia de un adulto es, aproximadamente, de $70-80\Omega$; en una situación de reanimación puede variar entre 15 y 150Ω , debido a diversos factores externos como el contacto de los electrodos con la piel, la ventilación asistida, etcétera.

Compresiones de alta calidad

Nuestros desfibriladores tienen la capacidad de identificar la impedancia transtorácica básica, la cual fluctúa levemente durante la RCP por la redistribución y el movimiento de los fluidos internos de la víctima, debido a las compresiones y las ventilaciones.

El algoritmo calcula y filtra las anomalías para obtener la variación efectiva (correlacionada con el flujo sanguíneo a consecuencia de las compresiones) para brindarle al primer respondiente retroalimentación acerca de la calidad de las compresiones que está ejecutando.

Plataforma centralizada de comunicación, base de datos y herramienta para el análisis de los estudios médicos

SEMA es un sistema de gestión de datos que permite la comunicación entre los dispositivos médicos **SCHILLER** y los sistemas de Registros Médicos Electrónicos. Posee una base de datos estándar (SQL) que almacena los datos crudos de la pruebas e intervenciones y cuenta con herramientas que permiten el análisis, validación y generación de reportes médicos en formatos de acuerdo a las necesidades.

ESTA PLATAFORMA LE OFRECE NUMEROSAS VENTAJAS

PLENA INTEGRACIÓN

SEMA admite la comunicación bidireccional con los dispositivos **SCHILLER** y la integración directa en archivos y sistemas de información hospitalarios. Eso maximiza la eficiencia para el tratamiento de los pacientes y un considerable ahorro de tiempo para la clínica, hospital o institución.

EFICIENCIA CLÍNICA

SEMA cuenta con herramientas avanzadas que le permiten al usuario analizar, validar y completar los procesos de trabajo en unos cuantos clics.

PERSONALIZABLE

Su intuitiva interfaz permite personalizar fácilmente los flujos de trabajo y las pantallas, de acuerdo a las necesidades de cada usuario. También es posible que éste defina informes, acrónimos y plantillas de interpretación como prefiera.

MAYOR SEGURIDAD

SEMA incluye funciones que brindan protección segura para los datos archivados. Por ejemplo, acceso basado en roles, desconexión automática, gestión de seguridad y directorio activo.

COMUNICACIÓN EFICIENTE

Nuestro monitor/desfibrilador **DEFIGARD Touch 7** (**DG Touch 7**) puede enviar estudios o el resumen de las intervenciones de manera segura a nuestra solución **SEMA** por medio de Wi-Fi, LAN o GSM.

Los **AEDs** de nueva generación, como el **FRED easyport plus**, cuentan con la opción de transmitir las intervenciones a **SEMA** a través del **SCHILLER BT Bridge**. Esto permite que el usuario, remotamente, obtenga una visualización, pueda realizar un análisis y hacer modificaciones específicas de la información en forma rápida y fácil, a través del acceso **SEMA Client**. Todo se integra con la data obtenida de otras de nuestras tecnologías.

Asimismo, a través de las licencias opcionales de **SEMA Client** los usuarios pueden ingresar desde el centro hospitalario y realizar la búsqueda de estudios por ID o nombre del paciente, agregar notas, modificar o agregar datos del paciente, banderas en puntos del ECG, y muchas opciones más.



VENTAJAS DE CONTAR CON EQUIPO DE EMERGENCIAS + SEMA SERVER + SEMA CLIENT



- **Flujo de trabajo STEMI y NSTEMI** (IAM con y sin elevación del segmento ST).
- Nuestra tecnología permite su identificación rápida y temprana gracias a que **DG Touch 7** cuenta con ECG en reposo de 12 derivaciones (con frecuencia de muestro de 32000 Hz), así como software interpretativo y transmisión del estudio a emails o **SEMA** para determinar conducta antes y durante el traslado.
- Esto permite que el centro asistencial se prepare para recibir al paciente.
- Transmisión del estudio posintervención disponible para cualquier versión del monitor/desfibrilador **HD7** y **DGTouch 7** con comunicación Wi-Fi o Ethernet (GSM sólo para **DGTouch 7**). Esta función permite que el personal pueda visualizar la data de manera remota una vez finalizada la atención.
- Posibilidad de que los especialistas y subespecialistas se conecten de manera remota (por **SEMA Client** o **SEMA Liberty Mobile**) para dar feedback sobre el estudio o el resumen de la intervención.
- Recepción de estudios de **DG Touch 7** (como ECG en reposo) desde el protocolo **ePCR (Electronic Patient Care Record)**.
- Búsqueda rápida de estudios del paciente y comunicación con EMR Hospitalario por medio de DICOM o HL7.
- Transmisión posintervención con el **AED Fred easypport plus** para almacenar el estudio y poder buscarlo posteriormente.

